
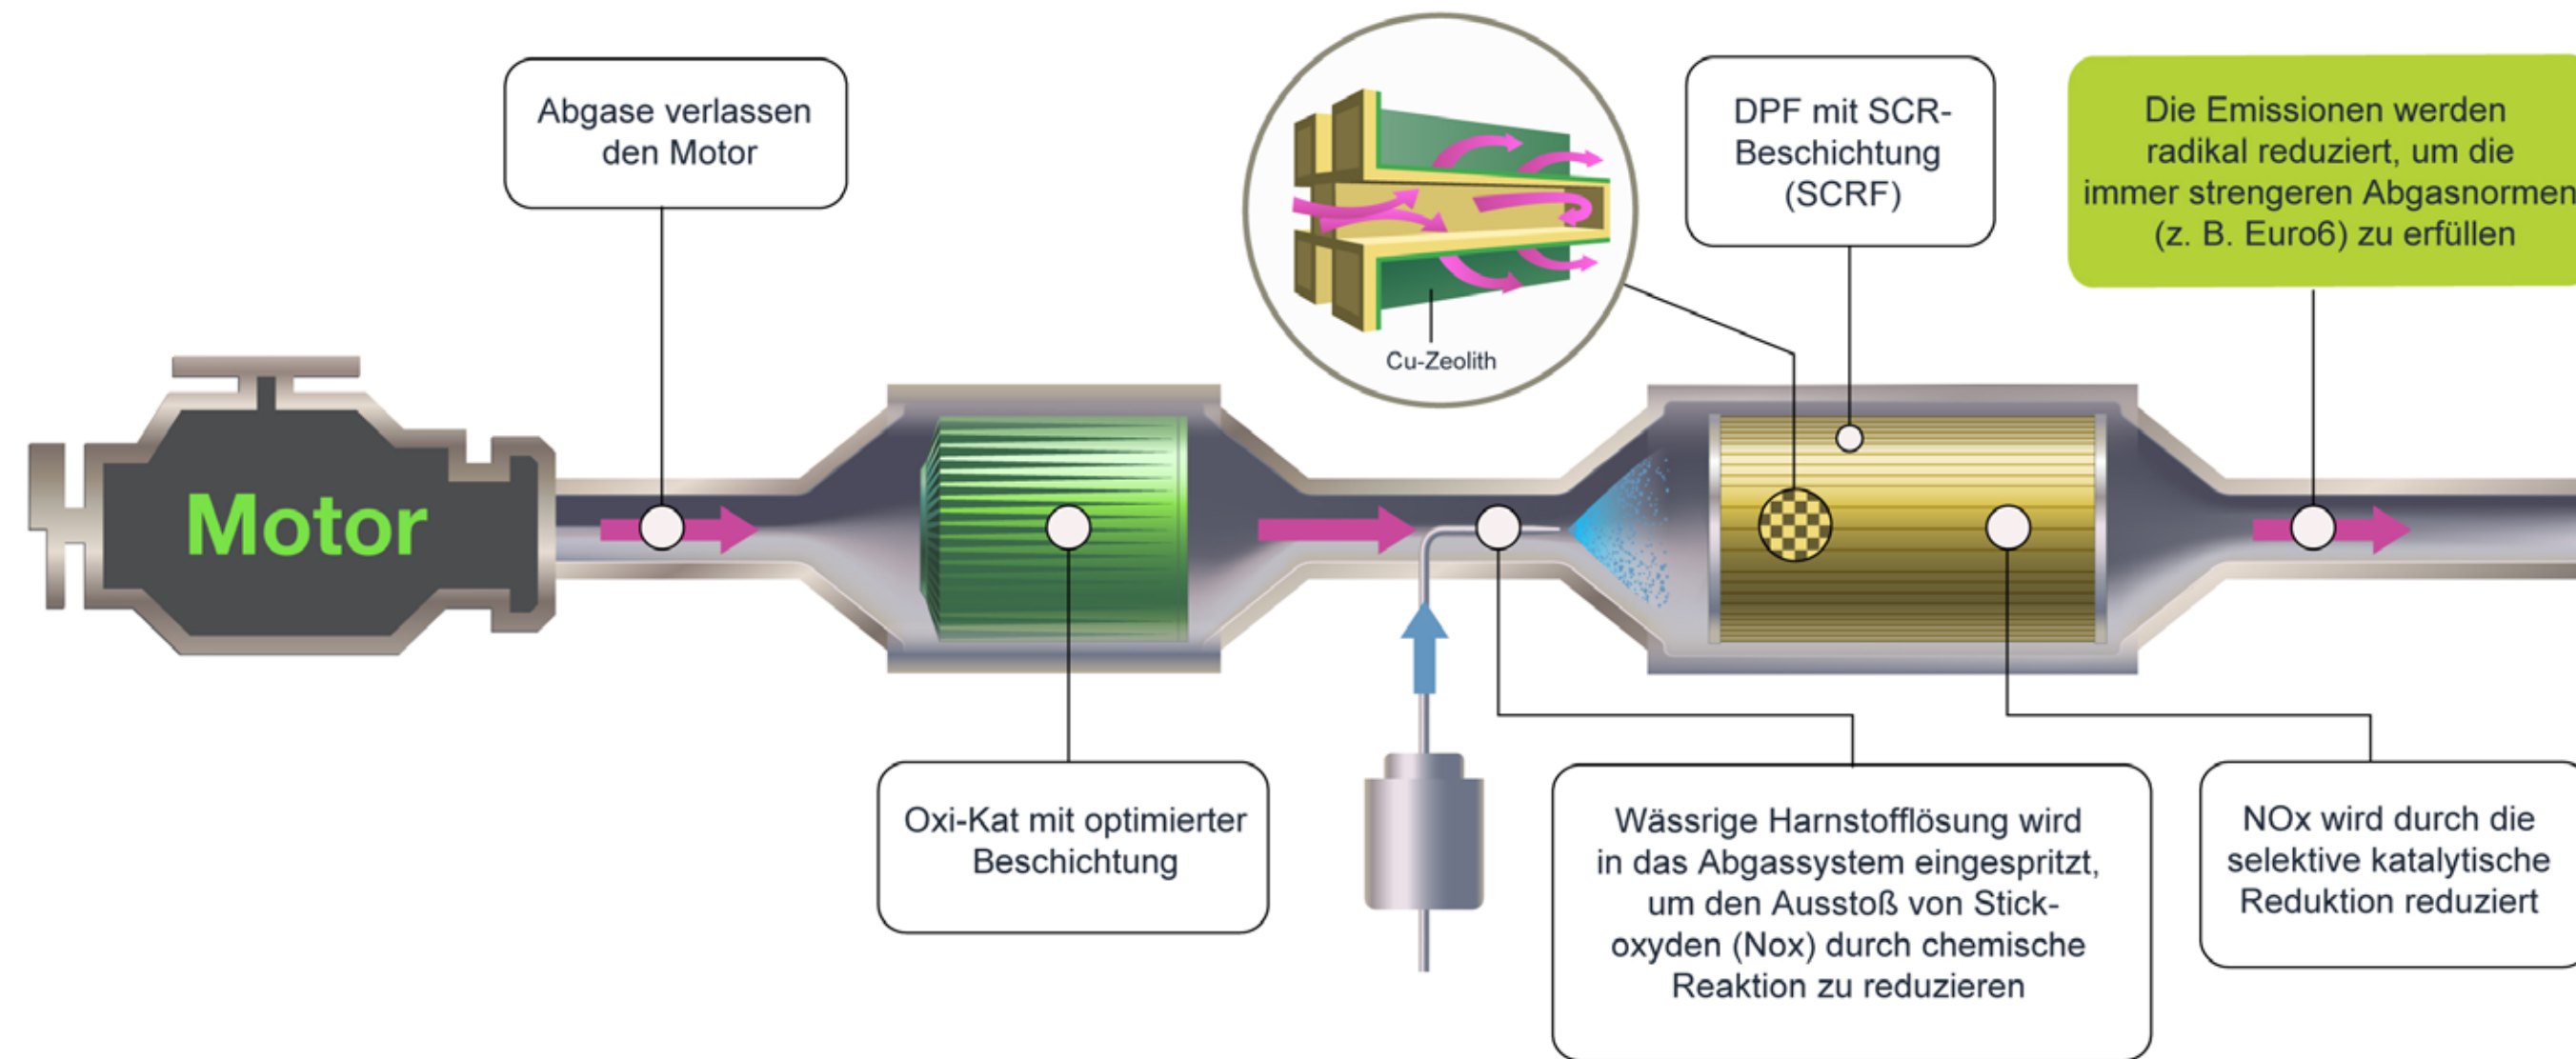


987 System-Wirkstoff SCR

Reinigt und schützt das gesamte SCR-System

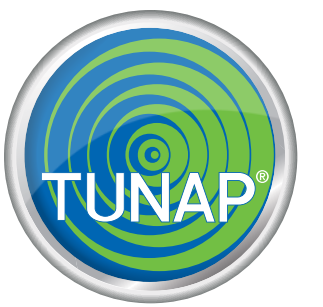

Das Problem

Oftmals werden die benötigten hohen Temperaturen im Abgassystem nicht erreicht, so dass der Harnstoff nicht vollständig in Stickstoff (N_2) und Wasser (H_2O) umgewandelt wird.

Dies führt dazu, dass:


- Weiße Kristallablagerungen am Harnstoff-Dosiersystem und dem SCR-Kat/SCRf entstehen
- Die NO_x -Reduzierung nicht entsprechend funktioniert und erhöhte Emissionswerte erreicht werden
- Motorstörungen und Leistungsverluste auftreten können

Die Lösung 987

- ✓ Schützt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren vor Kristallbildung
- ✓ Reinigt durch Kristallbildung beeinträchtigte Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren
- ✓ Endkundentaugliche Anwendung
- ✓ Handliche Dosierflasche mit Dosierskala

Anwendung

987 bei jeder Befüllung des Harnstofftanks im Verhältnis 1:400 anwenden.

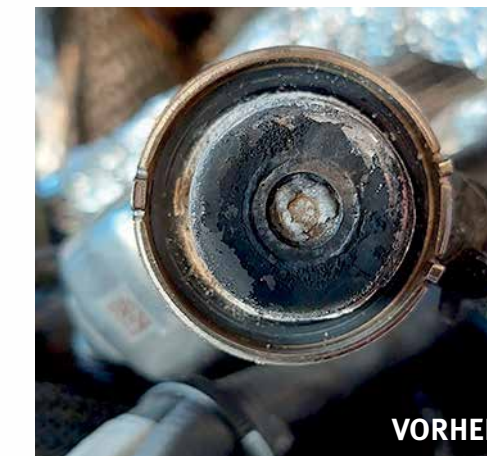

VORHER



NACHHER

GEEIGNET FÜR:



ZUM PATENT
ANGEMELDET

24
JETZT BESTELLEN

